



DESCARTABLES MEDICOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS


WWW.MYMDESCARTABLES.CL



NUESTROS PRODUCTOS

Todos nuestros productos son fabricados con tela SMS (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) de 45grs/m2, cuyas principales características son:

- Tela no tejida trilaminada, desechable, libre de látex, color azul médico, que garantiza una barrera microbiana, lo que impide el paso de los gérmenes patógenos de los fluidos.
- Es antiestática, eliminando cualquier tipo de interferencia posible con los equipos dentro del quirófano y otras maquinarias.
- Excelente permeabilidad al aire garantizando el confort del usuario, médico y paciente.
- La tela está formada por 3 capas de las cuales dos externas son de Spunbonded y una capa intermedia de Meltblown. Al hacer este "sándwich" de 3 capas, se obtiene una tela mejorada que combina las mejores propiedades de ambos tipos de telas.
- El resultado es una tela de muy buenas propiedades mecánicas: resistencia a la tensión, resistencia al desgarre, buena opacidad, excelente resistencia al paso de líquidos, es fresca (respira) y es suave. Al ser esta tela repelente, se evita el contacto de la piel en las intervenciones quirúrgicas con cualquier tipo de fluidos contaminantes, por lo cual ofrece una excelente barrera contra el riesgo de infecciones.
- Esta tela se hace a base de polipropileno hidrofóbico.
- Apto para esterilizar en vapor, ETO, peróxido de hidrógeno y plasma.

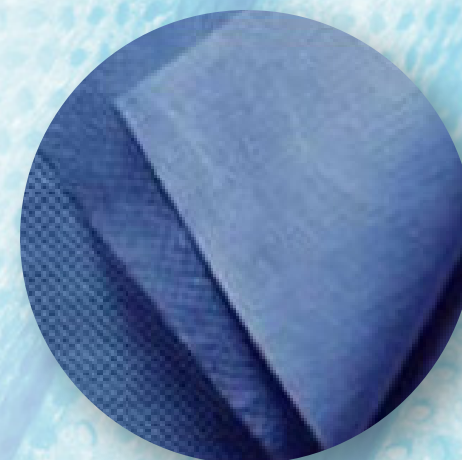

PACK ODONTOLÓGICO ESTÉRIL 087



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de tela bilaminada de 65grs/m² 100x100 cm.
- 4 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40cm.
- 2 Gorros de cirujano con tiras.
- 2 Mascarillas de 3 pliegues con elástico.
- 2 Batas quirúrgicas en SMS, talla L.
- 1 Campo clínico de SMS de 80x80 cm.
- 2 Tubulares de SMS de 150x7 cm.
- 1 Sábana dental con capucha fabricada en SMS de 120 x 200 cm, con fenestración de 10x10cm.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías dentales en que se requiera ambiente estéril.

Condiciones de Almacenamiento


- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

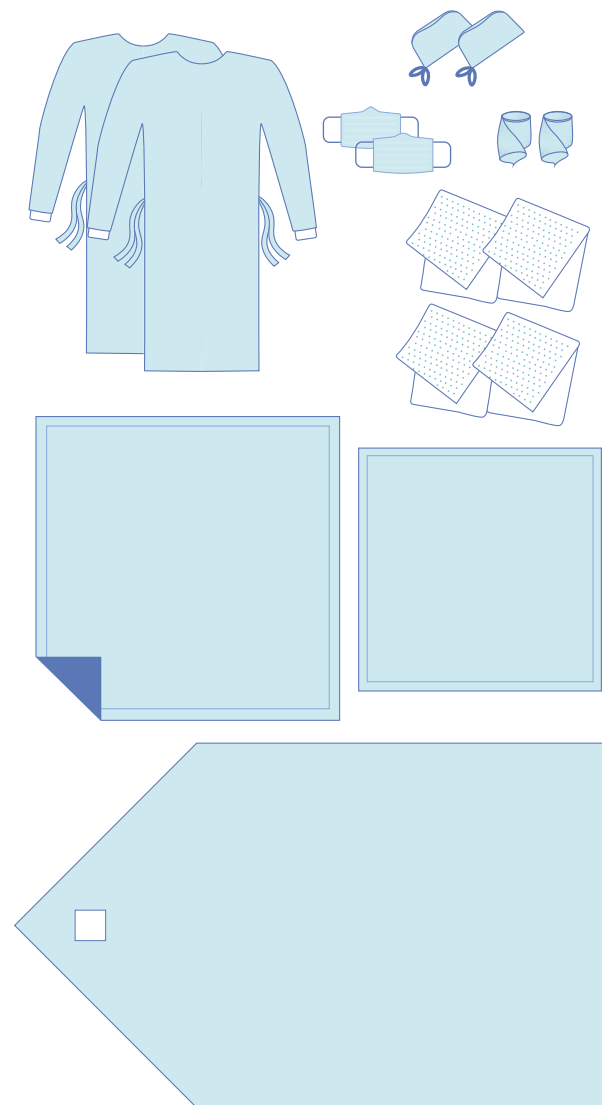

PACK ODONTOLÓGICO ESTÉRIL LIMITED



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera de tela bilaminada de 65grs/m² 100x100 cm.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40cm.
- 2 Batas quirúrgicas en SMS, talla L.
- 1 Campo clínico de SMS de 80x80 cm.
- 2 Tubulares de SMS de 150x7 cm.
- 1 Sábana dental con capucha fabricada en SMS de 120 x 100 cm, con fenestración de 10x10cm.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías dentales en que se requiera ambiente estéril.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTÉRIL EO

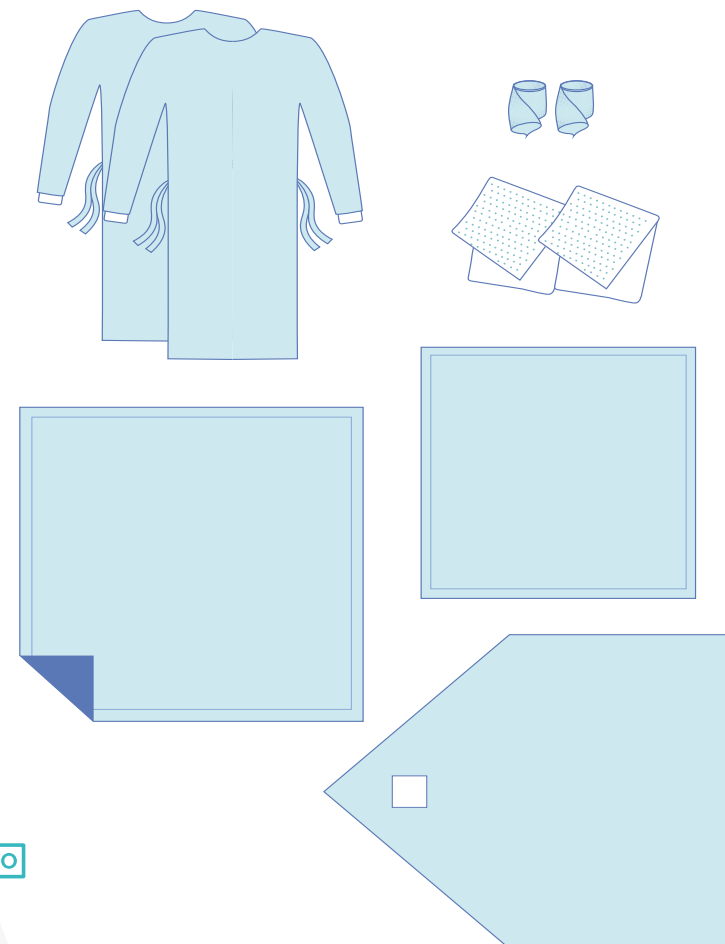

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK ESTÉRIL TERCER MOLAR



Contenido Paquete

Contenido

- 2 Campos clínicos de SMS de 80x80 cm.
- 1 Campo clínico de SMS de 80x80 cm, con fenestración de 8x8 cm y adhesivo.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para procedimientos dentales básicos en que se requiera ambiente estéril.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

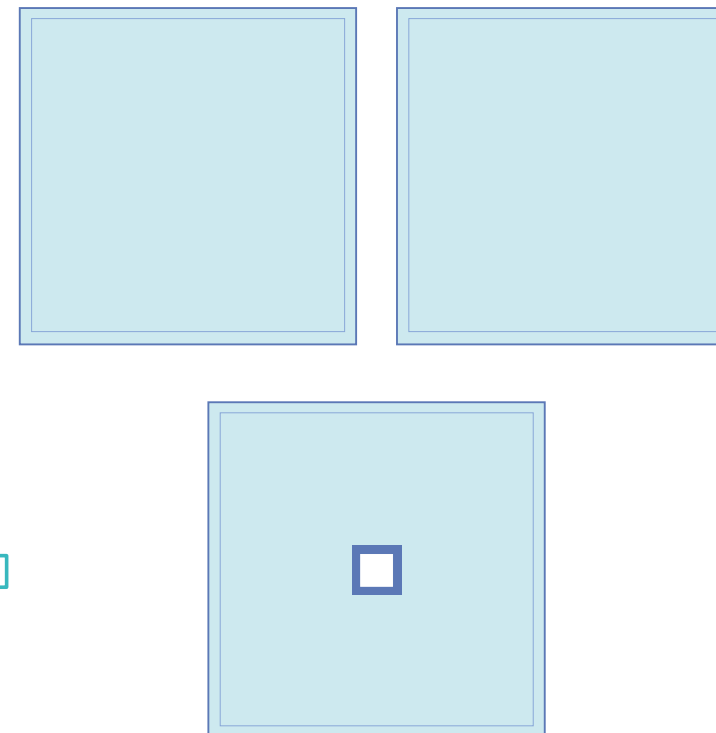

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK ESTÉRIL TERCER MOLAR CON BATA



Contenido Paquete

Contenido

- 2 Campos clínicos de SMS de 80x80 cm.
- 1 Campo clínico de SMS de 80x80 cm, con fenestración 8x8 cm y adhesivo.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40 cm.
- 1 Bata quirúrgica de SMS, talla L.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para procedimientos dentales básicos en que se requiera ambiente estéril.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

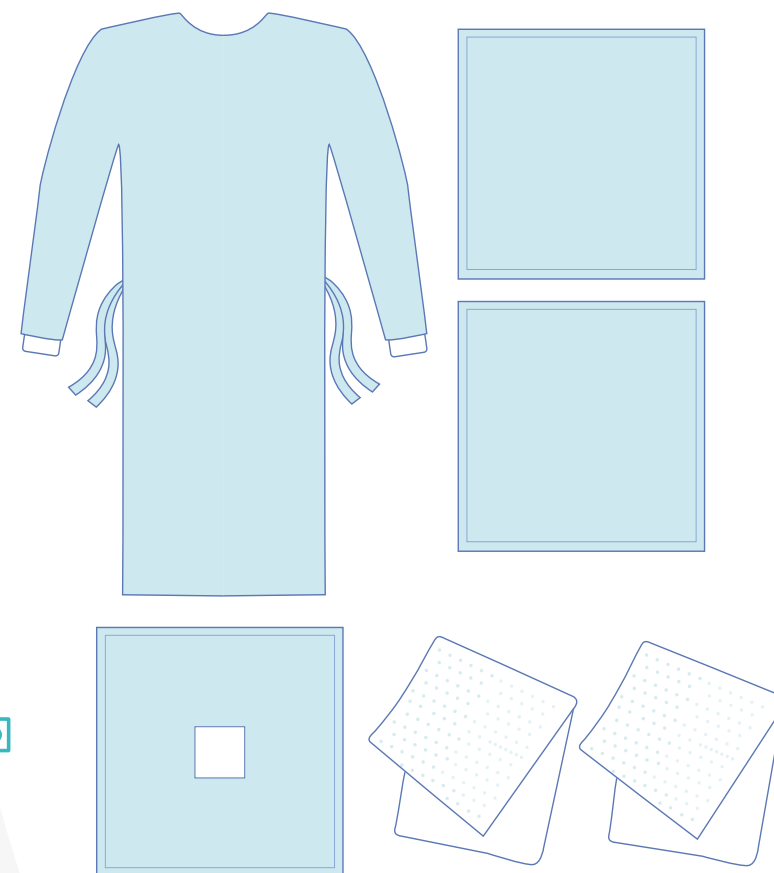

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK ESTÉRIL TERCER MOLAR CON TUBULAR Y TOALLAS



Contenido Paquete

Contenido

- 2 Campos clínicos de SMS de 80x80 cm.
- 1 Campo clínico de SMS de 80x80 cm, con fenestración de 8x8 cm y adhesivo.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40 cm.
- 2 Tubulares de SMS 150x7 cm.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para procedimientos dentales básicos en que se requiera ambiente estéril.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

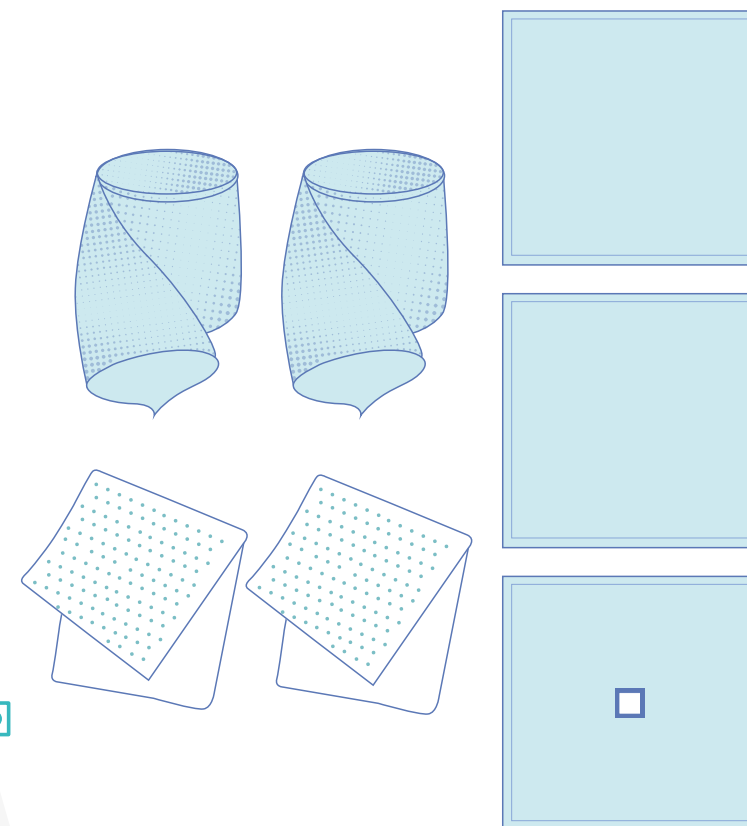

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK OFTALMOLÓGICO CATARATA 3B



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera en tela bilaminada de 65grs/m² 190x140 cm.
- 3 Toallas de mano de papel gofrado de 300x40 cm.
- 3 Batas quirúrgicas de SMS, talla L.
- 1 Funda mesa mayo de 120x60 cm con refuerzo de 60x80cm.
- 1 Cubre pantalla faco de nylon de 50x50 cm.
- 1 Sábana oftalmológica en tela bilaminada de 65grs/m² de 250 x 170 cm, con bolsa recolectora de fluidos, y apósito adhesivo de película.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido liso, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.



Condiciones de Almacenamiento


- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

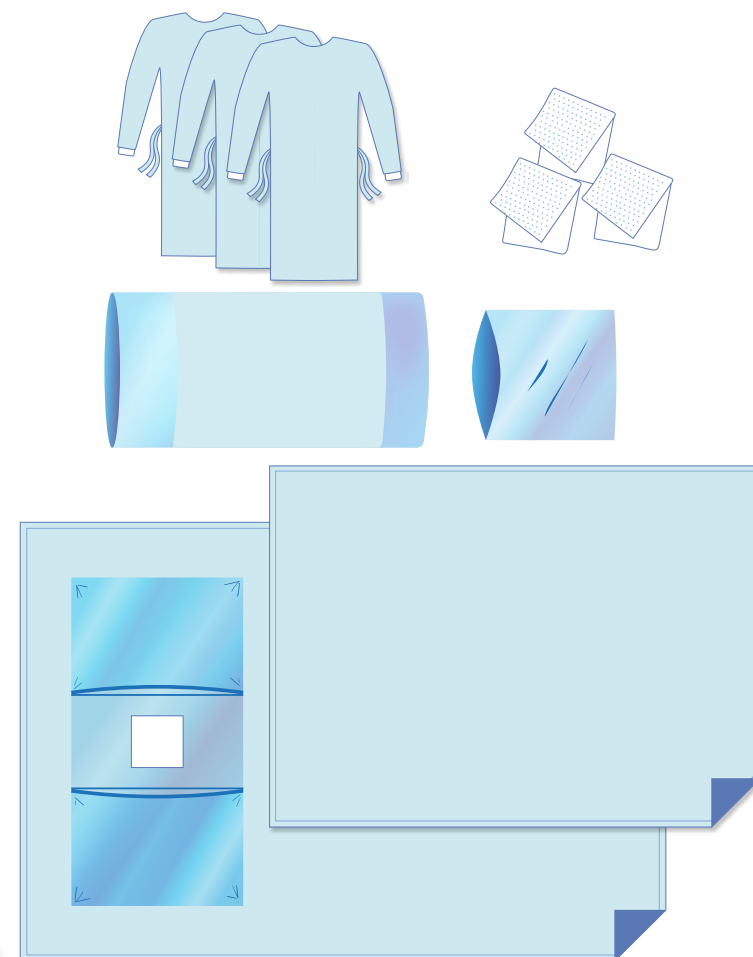

PACK OFTALMOLÓGICO CIRUGÍA LASER



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera en tela bilaminada de 65grs/m² de 100x100 cm.
- 4 Toallas de mano de papel gofrado 30x40 cm.
- 2 Batas quirúrgicas talla L, fabricadas en tela SMS de 45 grs/m², manga larga con puño, cuello redondo con cierre velcro, 4 tiras de amarre a la cintura cada una de 65 cm.
- 1 Campo clínico en SMS de 40x40 cm con fenestración circular de 6 cm de diámetro.

Características

- Confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías láser oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

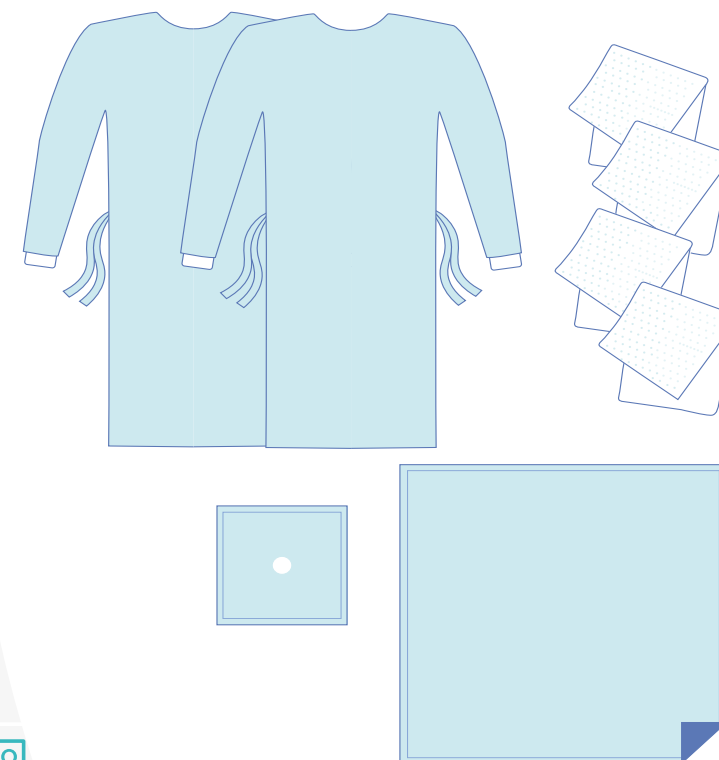

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK ESTÉRIL DE CIRUGÍA MENOR



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Campo de SMS de 60x60 cm con adhesivo lateral.
- 1 Campo de SMS de 80x80 cm, con fenestración de 10x10 cm y adhesivo.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40 cm.
- 1 Tubular de SMS de 150x7 cm.
- 1 Cubre mesa mayo de 120x60 cm con refuerzo de 60x80 cm.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Este modelo presentado es una de tantas alternativas de combinaciones de contenido. Se puede confeccionar con los requerimientos de acuerdo a las necesidades específicas de cada usuario.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de Esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

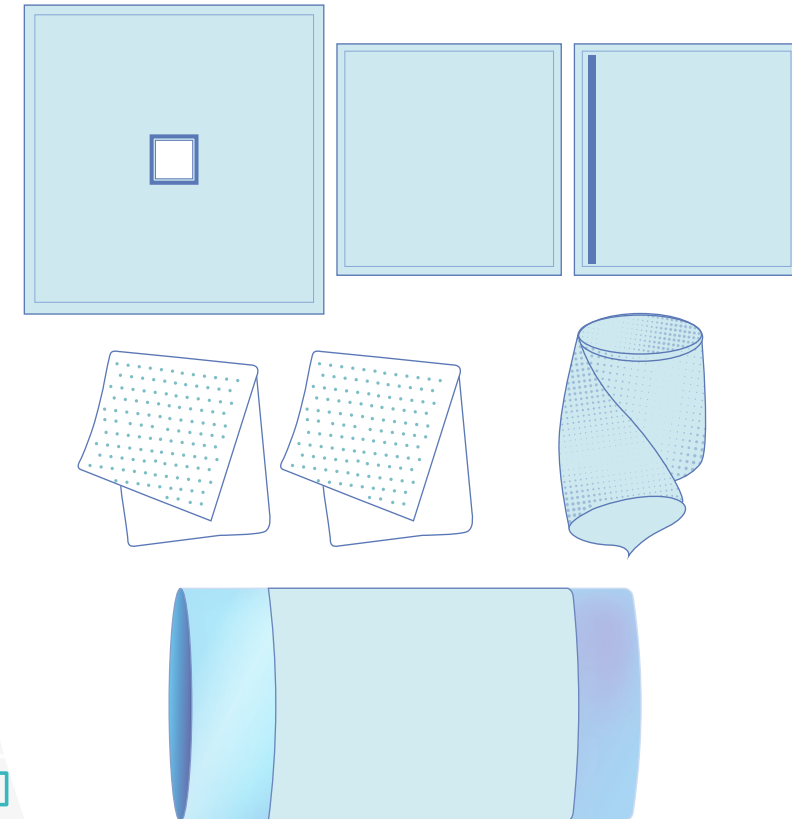

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



CAMPOS CLÍNICOS ESTÉRILES



Contenido Paquete

Contenido

- Campo clínico desechable en tela SMS.
- Disponibles lisos y fenestrados, con y sin adhesivo.
- Medidas estándares con stock permanente: 40x40 cms. / 50x50 cms. / 80x80 cms./
- Existe la opción de campos con otras medidas, lisos o con fenestración especial, con y sin adhesivo.


Características

- Campos clínicos confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.



Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

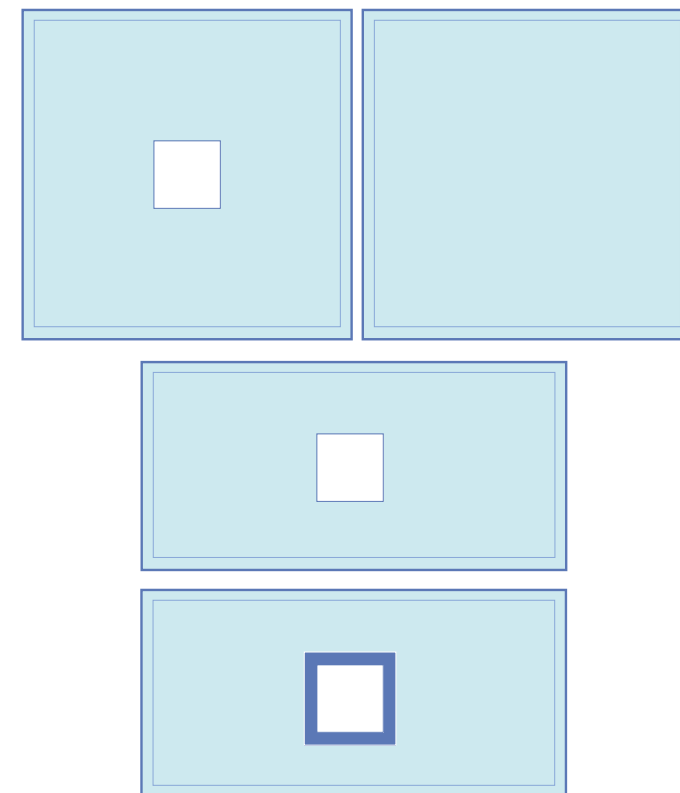

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



SÁBANA ODONTOLÓGICA ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Sábana dental en SMS, cosida con capucha de 120x200cm y fenestración 10x10 cm.

Características

- Confeccionada con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario



Condiciones de Almacenamiento


- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envases se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



SÁBANA OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Sábana oftalmológica de tela bilaminada de 65grs/m², de 250x170 cm y fenestración 10x10 cm con apósito adhesivo de película.
- Contiene bolsa recolectora de fluidos de polietileno en ambos lados de la fenestración.
- Envuelta en un campo clínico de SMS de 80x80 cm.

Características

- Confeccionada con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envases se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

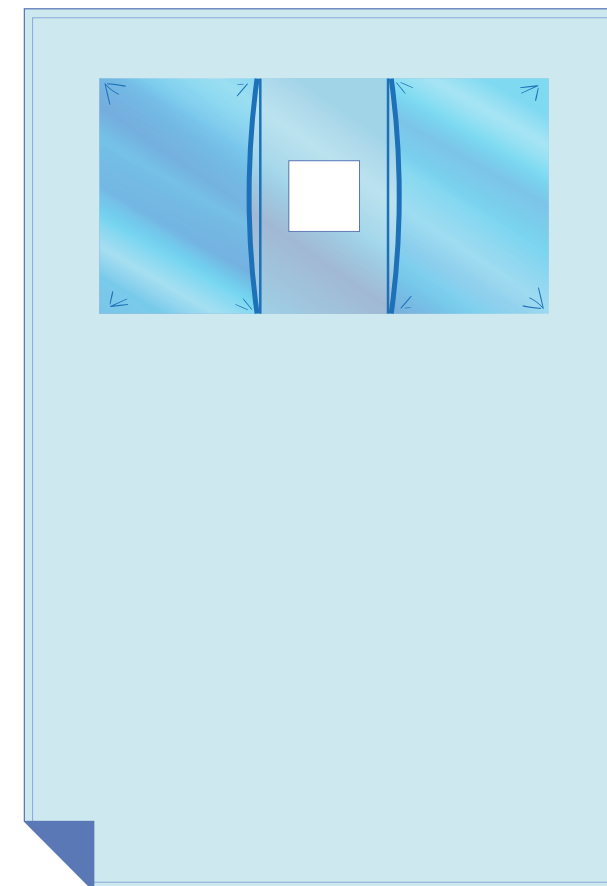

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Bata quirúrgica para adulto:
 - Disponible en talla M y L de tallaje nacional.
 - Manga larga con puño.
 - Cuello redondo con cierre velcro.
 - 4 tiras de amarre a la cintura cada una de 65 cm.
 - Color azul médico.
- 1 Campo clínico de SMS de 40x40cm.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x30 cm.

Características

- Material confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías donde se requiera un ambiente estéril.
- Las toallas de mano son fabricadas con material de máxima absorción



Condiciones de Almacenamiento


- Mantener en lugar fresco y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- Esterilizado en óxido de etileno.

ESTERIL EO

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

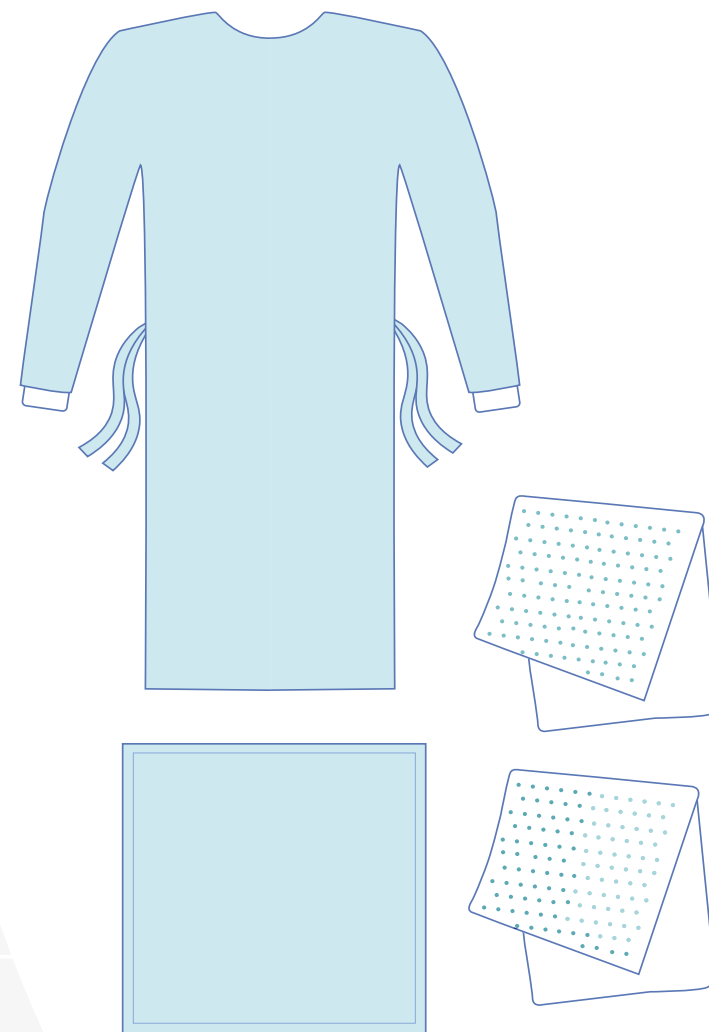

BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Bata quirúrgica para adulto
- Disponible en talla M y L de tallaje nacional.
- Manga larga con puño.
- Cuello redondo con cierre velcro
- 4 tiras de amarre a la cintura cada una de 65 cm.
- Color azul médico.

Características

- Bata de uso quirúrgico en material SMS de 45 grs. repelente a los fluidos.


Condiciones de Almacenamiento

- Material confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías donde se requiera un ambiente estéril.



Esterilización

- No.

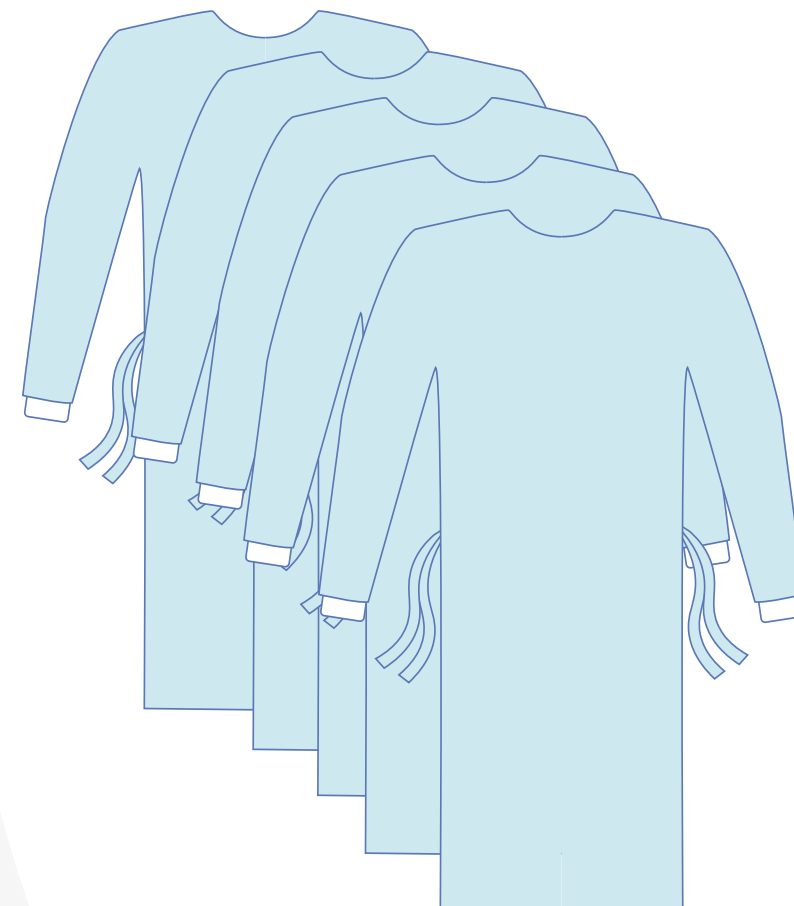

Presentación x5 unidades.

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



AMBO CIRUJANO NO ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Camisa manga corta con bolsillo en el pecho.
- Pantalón con amarra en la cintura. Bolsillo al costado de la pierna.
- Color azul médico.

Características

- Ambo cirujano para uso quirúrgico repelente a los fluidos en material SMS de 45 gr.
- Disponibles en tallas XS, S, M, L y XL (correspondientes a tallaje nacional).




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco.

Esterilización

- No.

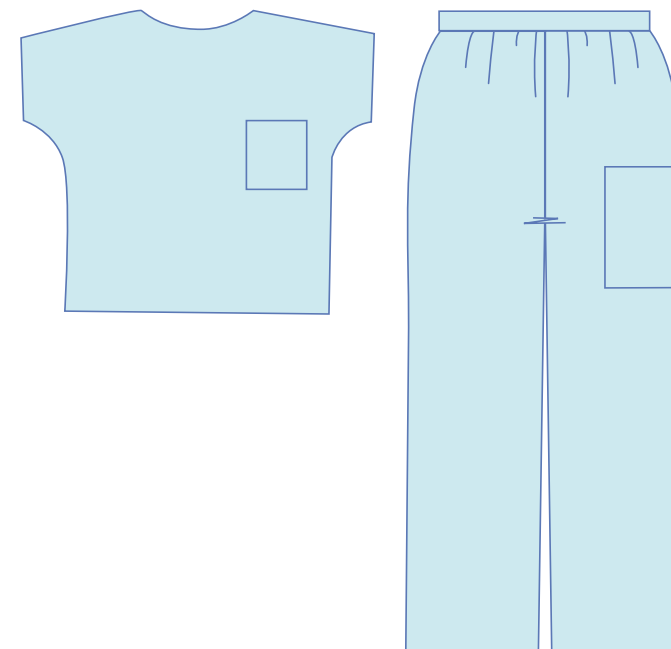

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



CAMISA PACIENTE BÁSICA NO ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Camisa paciente manga Kimono corta.
- Cuello escote en "V"
- 2 tiras de amarre a la cintura.
- Color azul médico.
- Abierta atrás.
- Disponible en talla única estándar L de tallaje nacional.

Características

- Camisa uso quirúrgico confeccionada con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco.

Esterilización

- No.

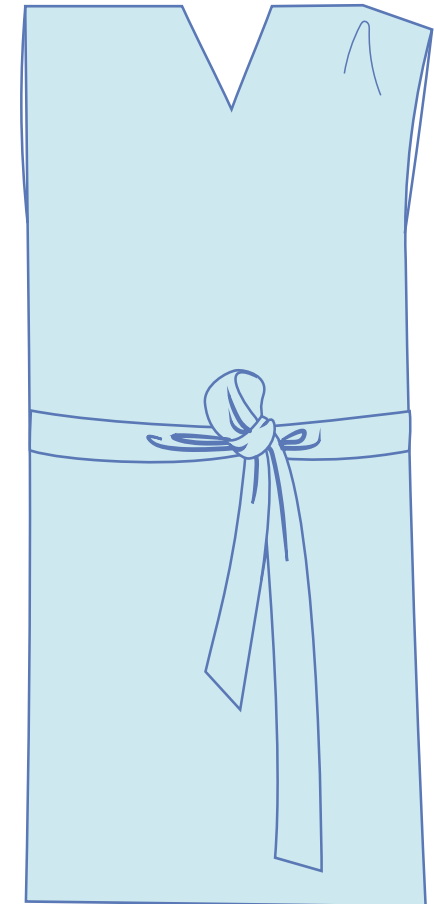

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



BUZO CON CAPUCHA DESECHABLE



Contenido Paquete

Contenido

- Buzo entero con cierre y capucha.
- Mangas elasticadas en los extremos.
- Piernas elasticadas en los extremos.
- Opcional con cubre-calzado incorporado.
- Disponible en versión estéril y no estéril. *Opcional.

Características

- Buzo entero fabricado en SMS, envasado por unidad. Disponible en talla S, M, L y XL de tallaje nacional.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

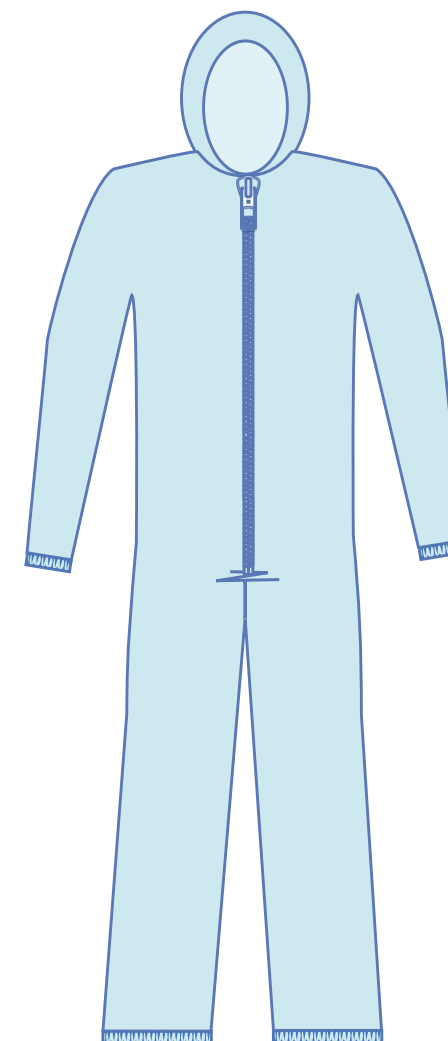

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



CUBRE CALZADO NO ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Cubre Calzado en material SMS.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Confección Nacional.
- Garantizan comodidad e higiene en entornos de acceso restringido.
- Talla única.
- Color azul médico.
- Presentación, bolsa de 100 unidades (50 pares).

Características

- Con elástico que permite sistema antideslizante en planta.
- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.



Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco.

Esterilización

- No.



Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



SÁBANA DESECHABLE



Contenido Paquete

Contenido

- Sábana desechable fabricada en SMS de 100x220 cm, elasticada en las cuatro puntas.

Características


- Confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Solo un uso.

Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco.

Esterilización

- No

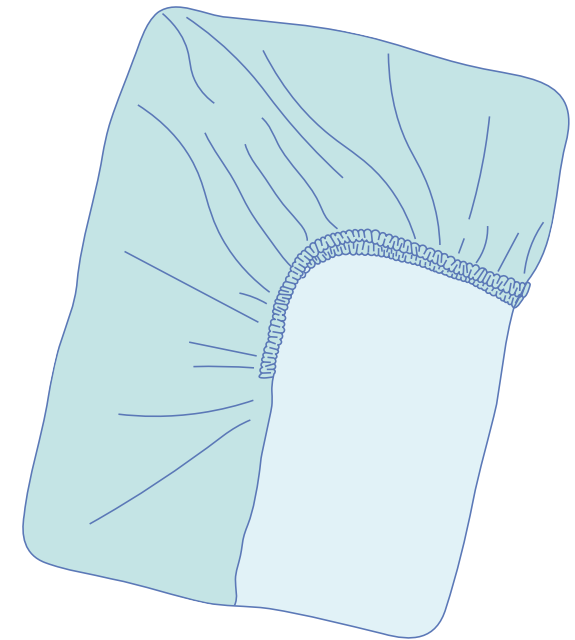

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



KIT DE CURACIÓN BÁSICO



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Tijera metálica.
- 1 Pinza quirúrgica en punta.
- 1 Pinza anatómica.
- 3 Gasas de 7,5x7,5 cm.
- 3 Tórulas de gasa.
- 1 Campo clínico de SMS de 40x40 cm.
- 1 Bandeja de distribución.

Características

- Equipo de curación descartable que se emplea como instrumental para curaciones básicas.






Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- Método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

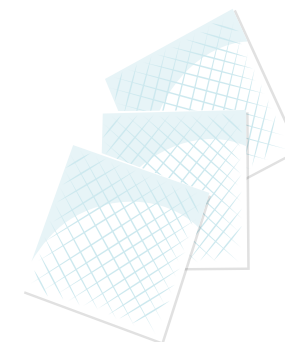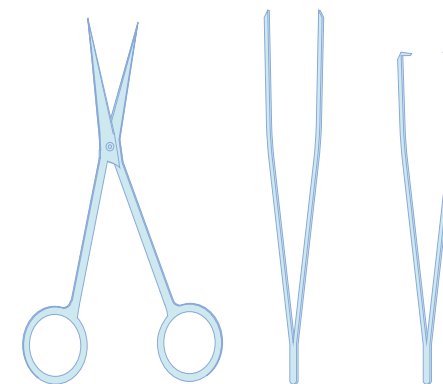

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



TUBULAR ESTÉRIL



Contenido Paquete

Contenido

- Tubular en SMS de 150cm de largo x 7cm de ancho.
- En formatos de 1 y 2 unidades.
- Con y sin adhesivo.

Características

- Confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

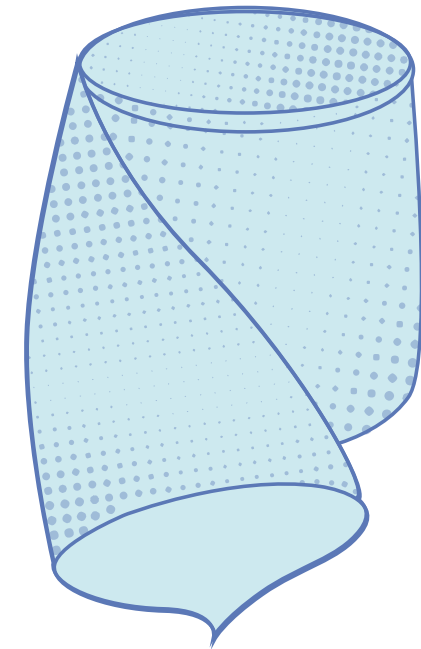

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



SAQUITO CUBREMANILLA



Contenido Paquete

Contenido

- Saquito de SMS de 8x20 cm.
- Elasticado en un extremo
- Presentación en sachet x 2 unidades estériles

Características

- Protector de manilla de lámpara confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envases se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

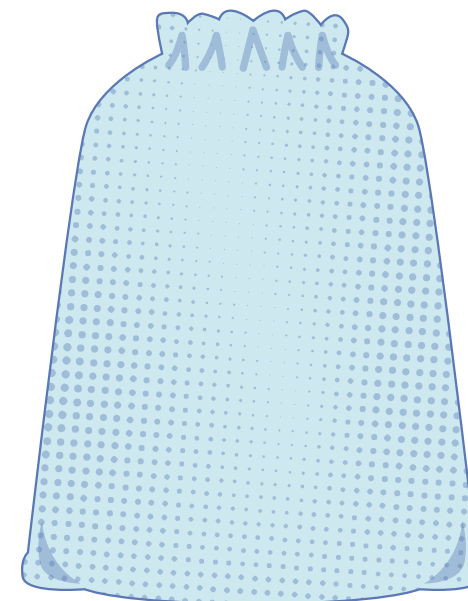

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



TUBO NO CONDUCTIVO PARA ASPIRACIÓN



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Tubo no conductivo para aspiración de 1.8 mts ó 3 mts. y de 6 mm de diámetro interior.

Características

- Tubo no conductivo para aspiración. Debido a su diámetro interior y a su conector cónico estriado, facilita la aspiración de alta resistencia.
- Presenta línea azul de identificación, además de un conector cónico estriado en ambos extremos.
- No tiene válvula anti-retorno.
- Producto hecho en PVC atóxico, libre de látex.


Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

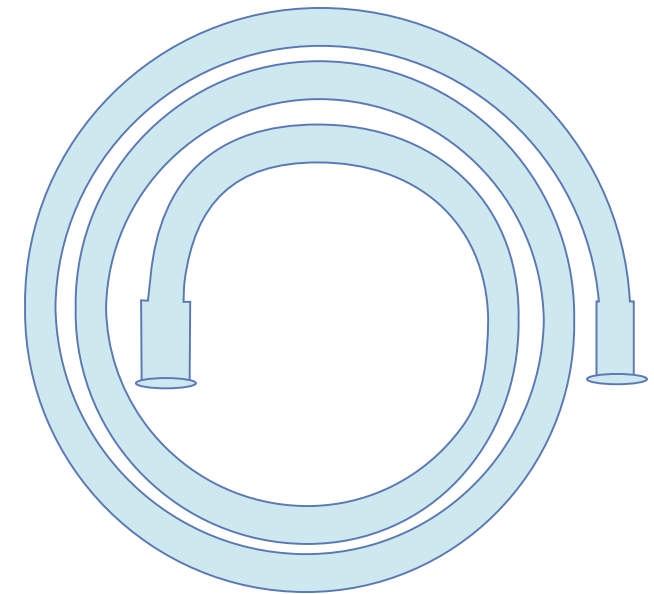


Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° 09/01/2012-00041** e inscripción **N° EDM 132/11**.



OTROS PRODUCTOS



- Somos fabricantes, podemos hacer diseños a medida según de las necesidades del cliente.
- Somos los expertos en fabricación de ropa quirúrgica desechable.
- Personalización con logotipo de su empresa.
- También vendemos los elementos individuales estériles.
- Todo fabricado en SMS de 45 grs/m² o bilaminado de 65gr/m², según corresponda.

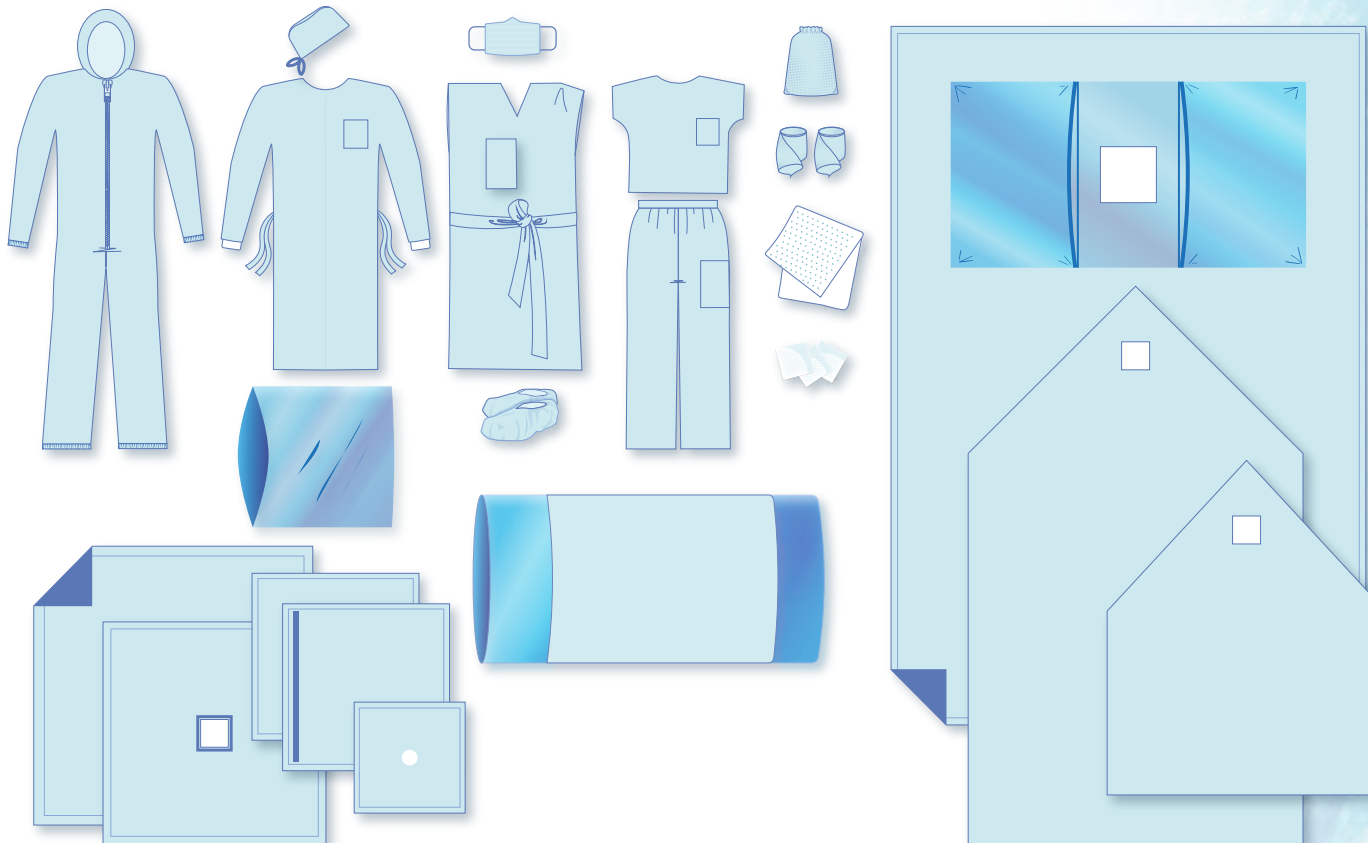

PACK QUIRÚRGICO UNIVERSAL



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera en tela bilaminada de 190x140 cm.
- 1 Bata quirúrgica talla L con dos toallas de mano.
- 2 Batas quirúrgicas reforzadas con 2 toallas de mano 30x40 cm cada una.
- 1 Funda mayo 80x145cm. reforzada
- 4 Campos SMS 65x40cm con adhesivo lateral de 3 cm.
- 2 sábanas laterales reforzadas de 120x200cm. con adhesivo de 5 cm.
- 1 Sábana superior reforzada de 146x240cm. y adhesivo
- 1 Sábana inferior reforzada de 190x200cm y adhesivo
- 1 Bolsa de suturas
- 2 indicadores de esterilización.

Características

- Tela transpirable para mayor comodidad.
- Resistente al agua, ideal para ambientes húmedos.
- Diseño ajustable para adaptarse perfectamente al usuario.
- Propiedades antiestáticas que mejoran la seguridad y el confort.
- Proporciona un 99% de protección bacteriológica mínima, garantizando una barrera eficaz.
- Certificación nivel 3 de protección según norma AAMI, adecuada para múltiples usos médicos y profesionales.


Condiciones de Almacenamiento

- Conservar en un lugar fresco, seco, limpio y con buena ventilación.
- Mantener en su empaque original para preservar sus propiedades.
- Rango de temperaturas recomendado: -5°C a 50°C; humedad relativa máxima: 80%.
- No utilizar si el empaque está abierto, dañado o en condiciones deterioradas.
- Evitar su uso cerca de llamas o fuentes de ignición.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

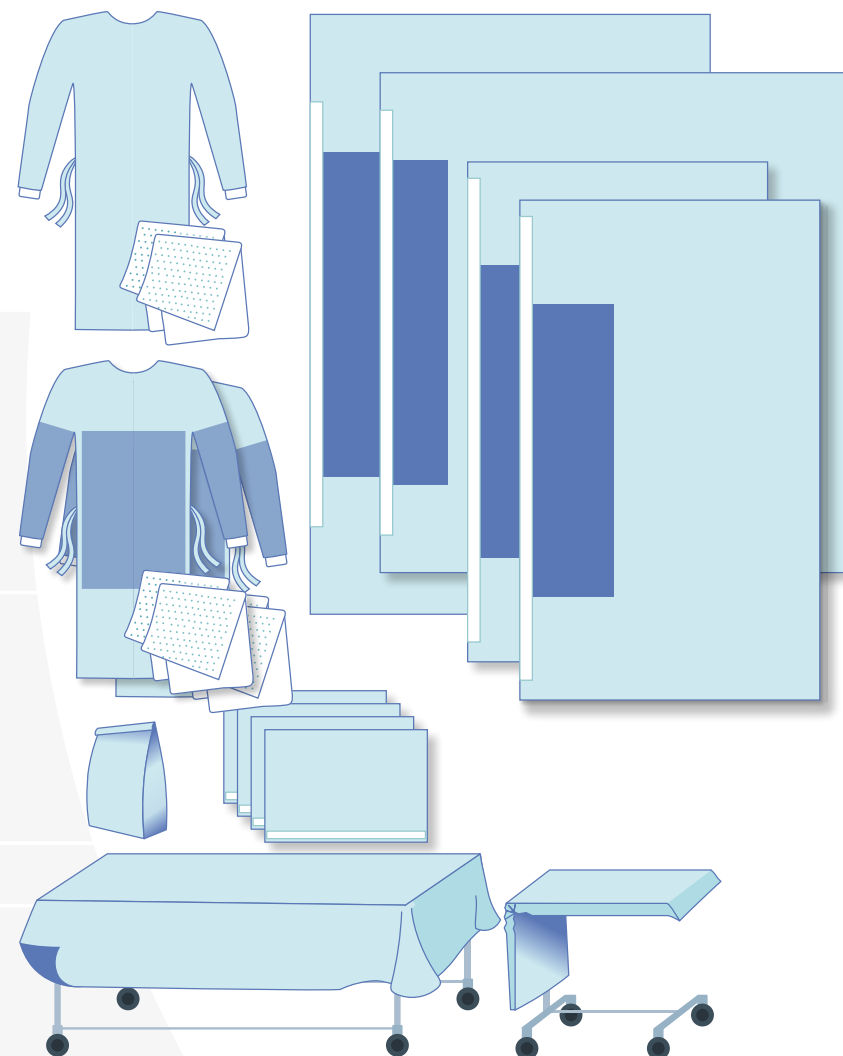

PACK OFTALMOLÓGICO CATARATA 2B



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera en tela bilaminada de 65grs/m² 190x140 cm.
- 2 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40 cm.
- 2 Batas quirúrgicas de SMS, talla L.
- 1 Funda mesa mayo de 120x60 cm con refuerzo de 60x80cm.
- 1 Cubre pantalla faco de nylon de 50x50 cm.
- 1 Sábana oftalmológica en tela bilaminada de 65grs/m² de 250 x 170 cm, con fenestración 10x10 cm, bolsa recolectora de fluidos y apósito adhesivo de película.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido liso, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

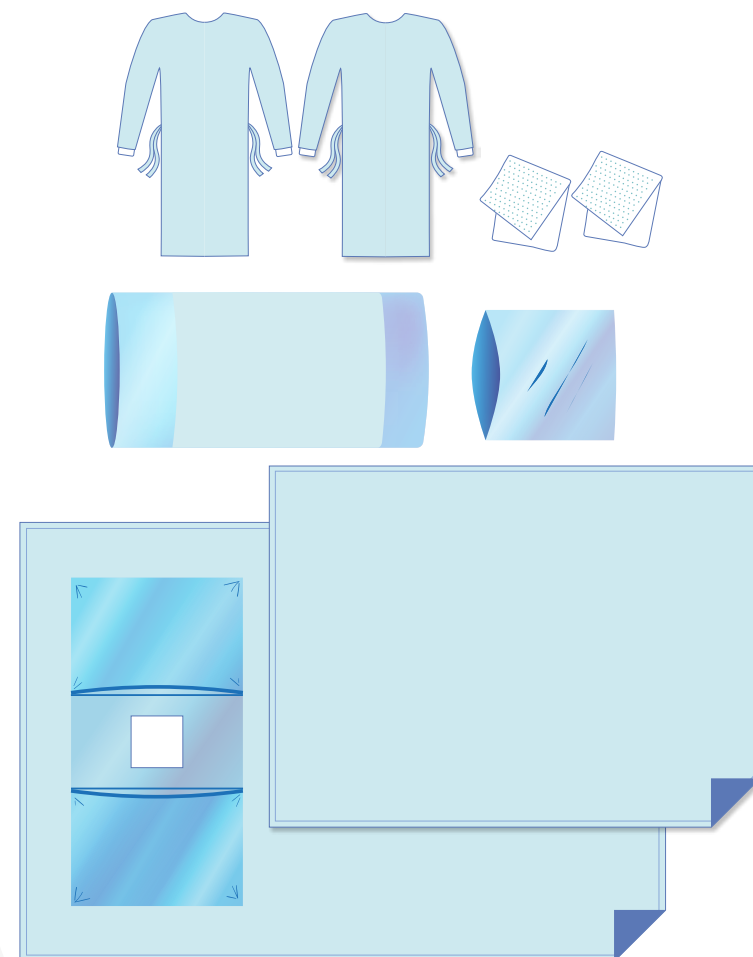

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK OFTALMOLÓGICO CATARATA 3B Y PARCHE FENESTRADO



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Cubierta de mesa arsenalera en tela bilaminada de 65grs/m² 190x140 cm.
- 3 Toallas de mano de papel gofrado de 30x40 cm.
- 3 Batas quirúrgicas de SMS, talla L.
- 1 Funda mesa mayo de 120x60 cm con refuerzo de 60x80cm.
- 1 Cubre pantalla faco de nylon de 50x50 cm.
- 1 Sábana oftalmológica en tela bilaminada de 65grs/m² de 250 x 170 cm, con bolsa recolectora de fluidos, fenestración 10x10 cm y apósito adhesivo de película con fenestración de 6 cm.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido liso, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.



Condiciones de Almacenamiento


- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

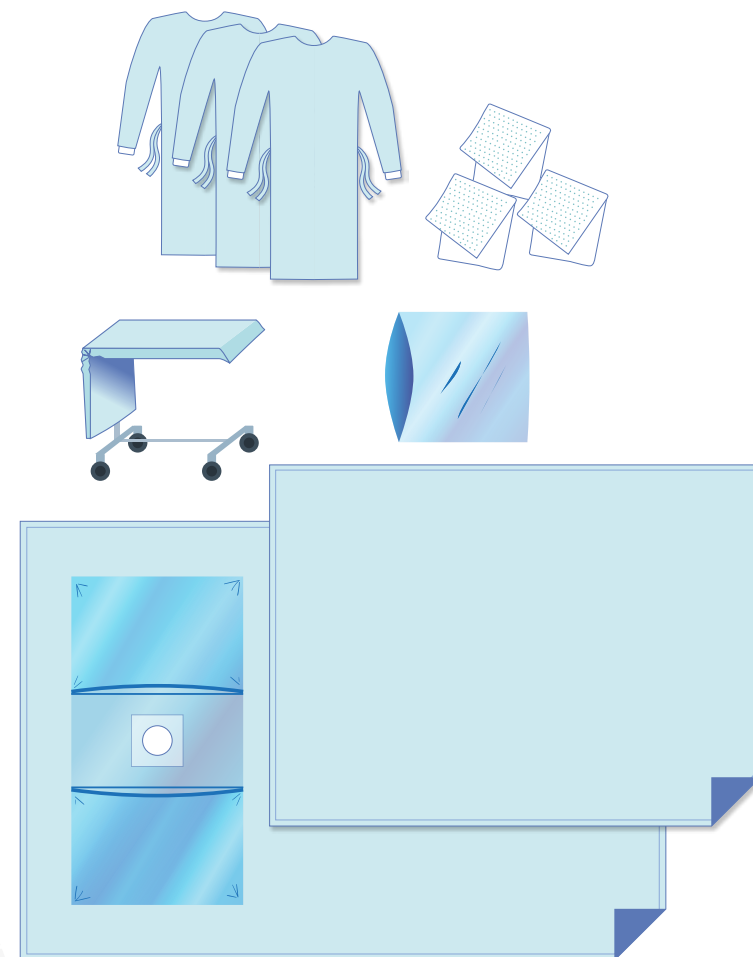

CAMPO OFTALMOLÓGICO 60X60



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Campo clínico desechable en tela SMS de 60x60cm.
- Fenestración central con forma de casa de 8cm.
- Con bolsa recolectora de fluidos y apósito adhesivo de película con fenestración de 6 cm de diámetro.


Características

- Campo clínico confeccionado con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.



Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

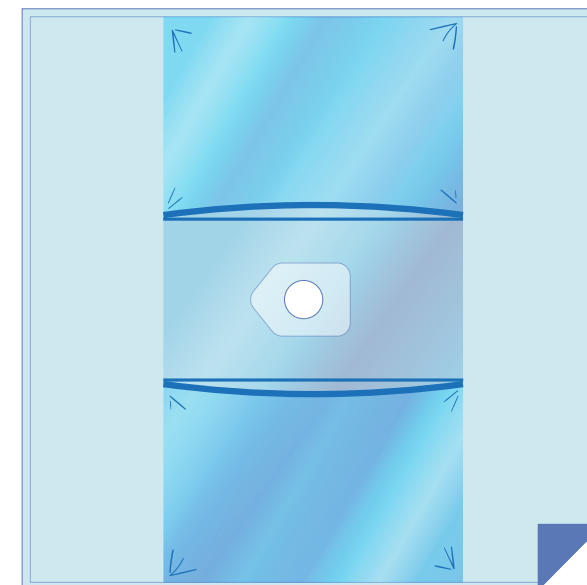

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK OFTALMOLÓGICO CIRUGÍA MENOR



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Campo SMS 120x150 cm. con fenestración rectangular de 6x18cm y adhesivo de 3 cm.
- 2 Bolsas recolectoras de fluidos, bilaterales de 20x20 cm con naricera.
- Para ser utilizado en aplicación de medicamentos, cirugía de pterigion, chalazion, cirugía de párpados.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido liso, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.




Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en lugar fresco, caducidad de dos años a partir de la fecha de esterilización y no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

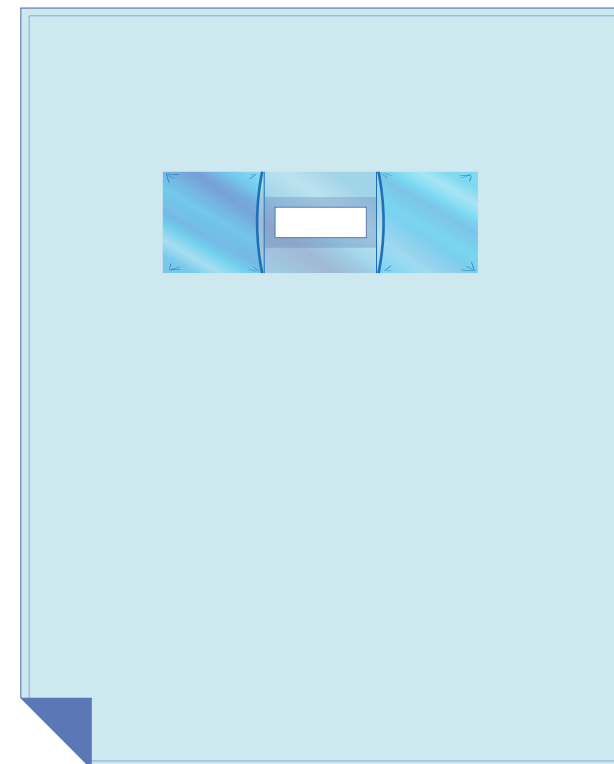

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.



PACK CIRUGÍA VETERINARIA



Contenido Paquete

Contenido

- 1 Campo SMS 150x100 cm.
- 1 Campo SMS 70x100 cm.
- 1 Bata quirúrgica talla L.
- 2 Toallas de mano.

Características

- Confeccionados con tela SMS de 45 grs, resistente a fluidos. Este material no tejido liso, está compuesto por capas externas, confeccionadas con fibras continuas, actuando como una excelente barrera contra agentes contaminantes.
- La forma de elaboración de esta tela sigue las bases tecnológicas recomendadas por el medio hospitalario.
- Su uso está destinado para cirugías oftalmológicas en que se requiera un ambiente estéril.





Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en ambiente seco, no usar si el envase se encuentra abierto o deteriorado. No usar en presencia de fuego.

Esterilización

- El método de esterilización es a través de óxido etileno.

ESTERIL EO

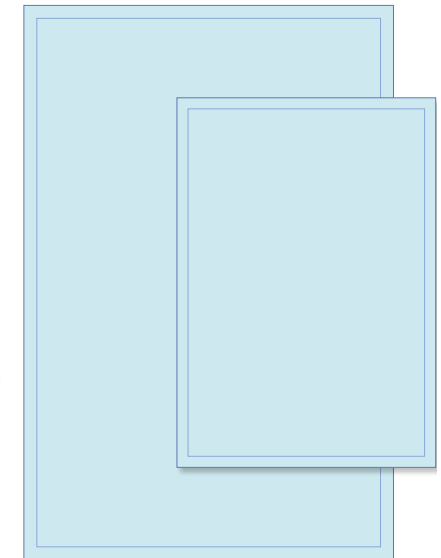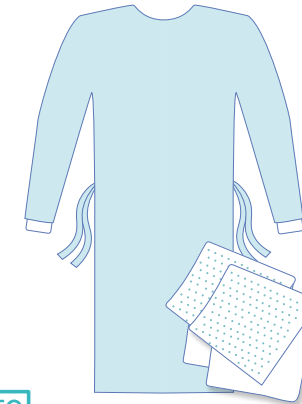

Certificado Revisión de Antecedentes que acompañan al dispositivo médico **ISP N° ANDID/1355/21** y Resolución Sanitaria **RS N°037382**.

